

Adásvételi szerződés

amely létrejött egyrészről

a **Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet** (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.)

számlaszám: MÁK 10023002-00333001-00000000.

adószám: 15813688-2-13

képviseli: Dr. Pusztai Dezső főigazgató

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő)

másrészről

a **Anamed Kft.** (1144. Budapest, Kőszeg u. 29.)

képviseli: Virág Krisztina cégvezető

cégjegyzékszám: 01-09-164933

adószám: 10737956-2-42

számlavezető bank, bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 10402283-50526766-72691008

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)

(a Vevő és az Eladó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek)

között az alulírott helyen és napon, az alábbiak szerint.

Előzmény

A Szerződő Felek rögzítik, hogy Vevő, mint ajánlatkérő „**Orvosi eszközök beszerzése 3 részben, határozott idejű adásvételi szerződés keretében**” tárgyban – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 113.§ (1) bekezdés alapján – lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárásban hozott döntésének megfelelően Eladóval köt szerződést a közbeszerzés **2. része** tekintetében.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződés alapján az Eladó teljesítésre a közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában, a közbeszerzési dokumentációban és az ajánlatában foglaltakra figyelemmel köteles. A szerződés tervezet minden rész vonatkozásában irányadó. A beszerzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A támogatói okirat száma: ÁEEK/25485-3/2019.

1. A szerződés tárgya, a Szerződő Felek jogai és kötelezettségei

1.1. Az Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. mellékletében meghatározott orvosi eszközt (a továbbiakban: Eszközt) Vevő részére a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott teljesítési helyre szállítja, üzembe helyezi és Vevőnek történő átadással, amelynek ellenében a Vevő a 3.2. pontban meghatározott vételárat fizet az Eladónak. Eladó továbbá vállalja az eszközt használó személyzet betanítását Vevő által kijelölt max. 5 fő részére, 1 óra időtartamban, valamint 1 órás próbaüzem tartását. Az üzembehelyezésről, a próbaüzem megtartásáról üzembehelyezési jegyzőkönyvet, az oktatásról, betanításról oktatási jegyzőkönyvet vesznek fel a felek. Eladó kijelenti, hogy a leszállított Eszköz gyári új.

1.2. Az ellenérték és az értékelési szempont szerinti elemek:

2.rész: Rádiófrekvenciás mikro-sebészeti generátor

Nettó össz. ajánlati ár (Ft):

5.150.000,- Ft

Értékelési szempont szerinti elemek:

Induló alapkészlet vágóhoz: 50 db osztott EH negatív lap kábellel összeépítve (Kérjük megadni!) (előny a több!): **50**

Kamerafej, egybeépítve vagy különálló adapterrel, mely képosztóval rendelkezik (endoszkópos és operatőr általi direkt obszervációs kép is lehetséges egyidőben) (igen/nem): **igen**

- 1.3. Eladó feladata továbbá a 12 hónap jótállási idő alatt szervizszolgáltatás biztosítása, amelynek alapján az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Eszközök szakszerű javításának és karbantartásának ellátása érdekében biztosítja a megfelelő szervizszolgáltatást.

A jótállási idő alatt a szerviz, javítási és karbantartási költséget az Eszközök jelen szerződésben meghatározott vételára magában foglalja, így különösen a tervezett kiszállási és az esetleges szállásköltségeket, anyag, alkatrész költségek, részleges, vagy teljes működésképtelenség elhárítása érdekében történő komplett javítások ellátását és költségét, munkadíjat, a karbantartás díját. A rendkívüli javítások költségei nem tervezhetőek, ezek a költségek a Vevőt terhelik.

A szerződés időtartama alatt az alábbiakban meghatározott szolgáltatásokat kizárólagosan az Eladó jogosult elvégezni:

- Üzembe helyezés és installáció 1 óra egybefüggő próbaüzem,
- Szerződés tartalma szerinti időszakos karbantartások
- Vevő hibájából adódó, nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodások javítása
- Az üzemviteli biztonság szempontjából történt javítások – fejlesztések

Az Eladó a gyártó által előírt gyakorisággal, szakszerűséggel és terjedelemben, de legalább évente két alkalommal (alkalmanként 1 napos időtartamban); a jelen szerződésben meghatározottak szerint végzi el az Eszközök tervszerű megelőző karbantartását, a Vevővel történő előzetes egyeztetést követően. A tervszerű megelőző karbantartás a jelen pontban részletezett munkák elvégzését foglalja magában.

Eladó a jelen szerződés tárgyát képező Eszközöket a rájuk vonatkozó szerviz előírások szerint ellenőrzi, mely során a vonatkozó MSZ előírások szerint jár el.

A jótállási időszak alatt meghibásodás esetén Eladó köteles Vevő értesítésétől számított 48 órán belül az Eszközök javítását megkezdeni. A javítások befejezése után – amennyiben Eladó a készüléket elszállította – Eladó köteles visszaszállítani Vevő számára az eredeti Eszközöket. A kijavított Eszközre a Eladó a jótállási kötelezettségét kiterjeszti. Minden leszállított tételről Eladó jótállási dokumentációt köteles rendelkezésre bocsátani.

Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem elégítik.

- 1.4. Az Eladó kijelenti, hogy az általa szállított Eszközök minden tekintetben megfelelnek a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívásában és a

közbeszerzési dokumentációban a Vevő által meghatározott követelményeknek, valamint az általa benyújtott ajánlatban foglaltaknak.

- 1.5. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *ka)–kb)* alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
- 1.6. Az Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.
- 1.7. Eladó által a teljesítésbe bevont alvállalkozók megjelölése (adott esetben): -
- 1.8. Eladónak együttműködési kötelezettsége van abban az esetben, ha Vevő a telepítés helyszínén a telepítést megelőzően, átalakítási, felújítási munkát végez, Eladónak ezt a tevékenységet túrníe kell és nem jelent akadályközlési alapot.
- 1.9. Eladónak tekintettel kell lennie a teljesítés során arra, hogy folyamatos üzemű egészségügyi intézmény részére végzi a teljesítést, így indokolatlanul nem zavarhatja a folyamatos betegellátás folyamatát.
- 1.10. Eladónak – a szállítást és teljes körű installációt követően hibamentes próbaüzemet kell végeznie és dokumentálnia. A próbaüzem megfelelőségét Vevő ellenőrzi.

2. A teljesítés helye, ideje és módja

- 2.1. A teljesítés helye:
2700 Cegléd, Törteli út 1-3.
- 2.2. Az Eladó az Eszközöket a 2.1. pontban megjelölt teljesítési helyre szállítja le. Teljesítési határidő: a szerződés aláírását követő 30. nap. Előteljesítés előzetes egyeztetés alapján lehetséges. Vevőnek kiemelt érdeke fűződik a legkésőbbi teljesítési határidő megtartásához arra tekintettel, hogy ezen legkésőbbi teljesítési időpont megtartása esetén van még kellő ideje és módja a pályázatban elnyert támogatás szerződéses ellenszolgáltatásként történő teljesítésére és a támogatás elszámolására.
Ezen időpontig a sikeres próbaüzemnek is meg kell történnie.
A Vevő elfogad előteljesítést.
Az Eladó köteles a Vevőt a tervezett teljesítés időpontjáról legalább 5 munkanappal megelőzően értesíteni.
A kárveszély átszállása az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásakor, míg az Eszközök tulajdonjogának átszállása a teljes vételár kiegyenlítésekor történik.
- 2.3. A Vevő vállalja, hogy az Eszközöket azok átvételekor, vagy azt követően legkésőbb 8 napon belül megvizsgálja, és azok felismerhető, mennyiségi vagy minőségi hibáit a vizsgálatkor felvett jegyzőkönyvben vagy a teljesítést igazoló dokumentumon („teljesítésigazolási jegyzőkönyv”) rögzíti. A Vevő a minőségi hibák felfedezése után köteles haladéktalanul írásban közölni az Eladóval szavatossági igényét.

- 2.4. Amennyiben az Eszköz nem megfelelő minőségű, úgy azt az Eladó saját költségén a szavatossági igény közlésétől számított 8 munkanapon belül kicseréli.
- 2.5. Az Eladó garanciális kötelezettsége nem terjed ki olyan esetekre, amikor a Vevő az Eladó előírásait nem tartotta be, vagy a teljesítés után a Vevőnél bekövetkezett körülmények hatására keletkeznek a hibák. A késedelmes bejelentésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.
- 2.6. A Vevő a minőségi kifogással érintett Eszköz felhasználására nem jogosult, a jogosulatlan felhasználásból eredő károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
- 2.7. Az Eszközzel kapcsolatos minőségi kifogás bizonyítása a Vevőt terheli. Az átvételkor nem látható minőségi hibákat az arra vonatkozó bizonyítékokkal együtt (Pl.:átadás-átvételi jegyzőkönyv, a jegyzőkönyvhöz képest tapasztalt eltérések leírása) a Vevő az Eladóval haladéktalanul, de legkésőbb az átvétel napjától számított 3 munkanapon belül írásban köteles közölni. A kifogás érvényesítésével együtt – az Eladó ilyen irányú igénye esetén – a Vevő köteles az általa hibásnak minősített Eszközt az Eladó rendelkezésére bocsátani.
- 2.8. A Vevő az általa kifogásolt Eszközöket az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül nem jogosult visszaküldeni, ellenkező esetben a Vevő az Eladó ebből eredő valamennyi kárát illetve költségét köteles megtéríteni. Amennyiben a Vevő minőségi kifogása megalapozottnak bizonyul az Eladó a Vevő oldalán felmerülő esetleges tárolási költségeket megtéríti, valamint a kárveszélyt viseli.

3. Vételár, fizetési feltételek

- 3.1. A Vevő előleg igénylésének lehetőségét nem biztosítja az Eladó számára.
- 3.2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Eladót szerződésszerű teljesítés esetén 5.150.000,- Ft + 27 % ÁFA, azaz Ötmillió-egyszázötvenezer forint + 27 % ÁFA, tehát **bruttó 6.540.500,- Ft**, azaz Hatmillió-ötszáznegyvenezer-ötszáz forint vételár illeti meg. A fenti ellenérték tartalmazza teljes egészében a megajánlott Eszközök ellenértékét, továbbá a szállítási költségeket, a fuvarszekőről történő lerakás, a telepítés helyszíne előkészítésének, az ehhez kapcsolódó meglévő eszközök leszerelési, bontási feladatoknak, a telepítés, az üzembe helyezés, a magyar nyelven történő betanítás, szállítói mérések (különösen érintésvédelem) *(adott esetben)* elvégzésének, a jótállási időszak alatt elvégzendő, gyártó által előírt kötelező szerviz költségeit, továbbá minden, az üzembe helyezéshez és műszaki csatlakozásokhoz szükséges tartozék, járulékos munka, rendeltetésszerű használathoz szükséges tartozék költségét.
- Az Eladó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha az Eladó a szerződésben meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul, a szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően teljesíti.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy Eladó az Eszközök teljesítési helyre történő szállításáért külön díjazásra nem jogosult.

- 3.3. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítésről a Vevő a minőségi, mennyiségi vizsgálat alapján, az átvételt követően a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 15 napon belül teljesítésigazolási jegyzőkönyvben nyilatkozik, és indokolt esetben közli

kifogásait az Eladóval. A Vevő képviselőjében a teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítására a műszaki osztály vezetője, távollétében kijelölt helyettese jogosult.

- 3.4. A számla kiállítására és benyújtására a teljesítésigazolás kézhezvételét követően kerülhet sor.

Az Eladó a számláját két példányban juttatja el a Vevő fejlécében megjelölt címére. A számlát az Eladó a Vevő nevére a fejlécében megjelölt címére (2700. Cegléd, Törteli út 1-3.) köteles kiállítani.

A számla benyújtásának (személyesen vagy postai úton) helye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Pénzügyi osztály.

Az Eladó által benyújtott számla teljesítése a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződésben foglaltak szerint 30 napon belül az Eladó fejlécében megjelölt bankszámlájára utalással történik, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire figyelemmel.

A számla kiegyenlítéséhez az alábbi okmányokat kell megküldeni:

- egy eredeti és egy másolati számlapéldányt cégszerűen aláírva,
- az átvevő által aláírt és lebélyegzett teljesítést igazoló okmányt.

A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vevő mindaddig nem köteles teljesíteni fizetési kötelezettségét, amíg az Eladó nem csatolja a számlához a Megrendelő teljesítésigazolója által aláírt teljesítést igazoló dokumentum eredeti példányát.

- 3.5. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a szerződés iktatószámát, a szerződés tárgyát és az Eladó jelen szerződés fejlécében meghatározott adatait. Ennek hiányában kiegészítés céljából a számlát a Vevő visszaküldi az Eladó részére, amely esetben a Vevő késedelme kizárt.
- 3.6. A nem megfelelően kiállított, vagy a jelen szerződésben előírt tartozékokkal nem rendelkező számlát a Vevő visszaküldi az Eladónak. Az Eladó által ismételt benyújtott számla kiegyenlítésére vonatkozóan a fizetési határidő az ismételt benyújtott számla Vevő általi kézhezvételének napjától számítva újratekintődik.
- 3.7. A benyújtott számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglaltaknak.
- 3.8. Vevő fizetési késedelme esetén a szerződés időtartama alatt a Ptk. 6:155.§ (1) – (2) bekezdéseiben foglaltak alapján kiszámított mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

4. Az Eladó nem szerződésszerű teljesítése, kötbér, a szerződés megszűnése

- 4.1. Az Eladó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén Vevő egyoldalú nyilatkozatával a szerződéstől elállhat, ami a szerződést a megkötésére visszamenő hatállyal felbontja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését.
- 4.2. Az Eladó köteles a Vevőt minden olyan körülményről haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelős.

- 4.3. Amennyiben az Eladó – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, úgy a Vevő – a szerződésszegésből fakadó egyéb igényein túl – késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőtől számítva a – késedelmesen szállított Eszközök - nettó vételárának 4%/nap, maximum a késedelmesen szállított Eszközök nettó vételárának 20 %-a.
- 4.4. Amennyiben az Eladó teljesítése nem felel meg a jelen szerződésben, valamint a szerződés 1. mellékletében meghatározott feltételeknek, illetve a teljesítés során a Vevő által megfogalmazott igényeknek, úgy Vevő a jótállás szabályai szerint járhat el.
- 4.5. A Vevőnek jogában áll a késedelmi kötbért az esedékes vételárba beszámítani, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak.
- 4.6. Ha az Eladó a jelen szerződésben meghatározott feladatának teljesítésével 5 napot meghaladó késedelembe esik, a Vevő felmondhatja a szerződést és meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek mértéke a teljes nettó vételár 20%-a.
A Vevő ez esetben egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megállapíthatja a teljesítés meghiúsulását, a meghiúsulási kötbér a nyilatkozat közlésének napján válik esedékessé.
- 4.7. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a Vevő – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk) 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbér mellett a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, valamint, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.
- 4.8. A Vevő a kötbérigényét írásban köteles közölni az Eladóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
- 4.9. Amennyiben a szerződésben meghatározott kötbér meghaladja a kötbérmaximumot, úgy Vevő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amely esetben az Eladó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
- 4.10. A Vevő a Kbt. 143. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jelen szerződést felmondja, ha:
a) Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel;
b) az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés *k)* pont *kb)* alpontjában meghatározott feltétel.
- 4.11. A 4.12. pont szerinti felmondás esetén az Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített Eszközök szerződésszerű vételárára jogosult.
- 4.12. A Vevő jogosult továbbá a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállni a Kbt. 143. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott esetekben.
- 4.13. Késedelmi kamat: a késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § szerint.

5. Kapcsolattartás

- 5.1. A Szerződő Felek a szerződés teljesítésének elősegítése érdekében kapcsolattartó személyeket jelölnek meg az alábbiak szerint:
- Vevő képviselője: Morvai Gábor műszaki osztályvezető
telefon: +36 53/310-011/101 mellék, fax: + 36 53/310-860, e-mail: morvai.gabor@toldykorhaz.hu
 - Eladó képviselője: Dám Éva
telefon: +36 1/220-9236, fax: +36 1/221-5531, e-mail: kozbeszerzes@anamed.hu
- 5.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás között minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, szükség szerint tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax útján kell megküldeni, amely akkor tekinthető szabályszerűnek, ha azt a kapcsolattartó személyek részére kézbesítették. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. A felmondást és az elállást írásban, tértivevényes levélben kell a másik féllel közölni.
- 5.3. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás érkezett.
- 5.4. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
- 5.5. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt változásról a másik felet haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül értesítik. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba. A kapcsolattartók személyének vagy adatainak változása nem minősül a szerződés módosításának.

6. Titoktartás

- 6.1. A Szerződő Felek a jelen szerződéssel, valamint az annak során teljesített szolgáltatással kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Az Eladó a birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében használhatja fel.
- 6.2. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a Vevő jogosult a teljesítés megkezdéséig jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni, a teljesítés megkezdését követően a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Az elállás vagy a felmondás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.

- 6.3. Az Eladó vállalja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3)-(3a) bekezdésére figyelemmel üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról. Az Eladó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli.
- 6.4. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszeréből finanszírozott beszerzések és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír.
- 6.5. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül.
- 6.6. Az Eladó tudomásul veszi, hogy Vevő a szerződés megnevezését (típusát), tárgyát, a Szerződő Felek nevét, a szerződés értékét, időtartamát, valamint az említett adatok változásait a szerződés létrejöttét követően honlapján közzéteszi.

7. Vitás kérdések rendezése

Az Eladónak és a Vevőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Szerződő Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

8. Egyéb rendelkezések

- 8.1. A Szerződő Felek a szerződést kizárólag írásban, a Szerződő Felek képviselői által aláírt okirattal módosíthatják figyelembe véve a Kbt. 141. §-ában foglaltakat.
- 8.2. Az Eladó kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül.
- 8.3. Az Eladó a 8.3. pontban foglalt nyilatkozatában foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles a változásról a Vevőt tájékoztatni. Amennyiben az Eladó 8.2. vagy 8.3. pont szerinti nyilatkozata valótlan tartalmú, a Vevő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől azonnali hatállyal eláll.
- 8.4. A Szerződő Felek a Ptk. 6:1. § (3) bekezdése alapján megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő követelések tekintetében az elévülést a Ptk. 6:25. § (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően a követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás is megszakítja.

8.5. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, vagy rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.

A szerződés értelmezése vagy bármely jellegű vizsgálata esetében a Vevő birtokában lévő példány tartalma és szövege az irányadó.

8.6. A Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Infotv. és a Kbt. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek a jelen szerződést – annak elolvasása és értelmezése után –, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag négy példányban aláírják.

Mellékletek:

1.sz.melléklet: Ajánlattételi táblázat

2.sz.melléklet: Műszaki leírás

Cegléd, 2019. november 18.

.....
Dr. Pusztai Dézso Főigazgató
főigazgató
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Vevő

Bp. 2019. nov. 21.

.....
ANAMED KFT
1144 Budapest, Kőszeg utca 29.
Tel.: (1)221-9236 Fax: (1)221-5531
Adószám: 10737950-2-42

Virág Krisztina
cégvezető
Anamed Kft.
Eladó

Pénzügyileg ellenjegyzem:

.....
Bobál István
gazdasági igazgató

Pénzügyi ellenjegyzés dátuma:
Cegléd, 2019. november 18.

KITÖLTENDŐ!
(részenként)

AJÁNLATTÉTELI TÁBLÁZAT
A Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet

„Orvosi eszközök beszerzése 3 részben”
elnevezésű eljárásban

2. rész: Rádiófrekvenciás mikro-sebészeti generátor

Mennyiség: 1 db

Gyártó: Olympus Winter & Ibe GmbH, Covidien IIc (E7507 EH negatív lap)

Típus: Celon Elite ESG-200

Szervizt ellátó cég neve, elérhetősége: Anamed Kft. 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Tel: 06-1-220-9236, Fax: 06-1-221-55-31

e-mail: posta@anamed.hu

Garancia idő hossza: 12 hónap

A gyártmány osztályba sorolás szerinti CE tanúsítványának száma: HD 60103917 0001
CE 00500

Minimum műszaki előírás	Elvárás	Ajánlott paraméter
Bipoláris, monopoláris és rádiófrekvenciás vágó-coaguláló		Bipoláris, monopoláris és rádiófrekvenciás vágó-coaguláló Celon Elite ESG-200
Maximális kimenő teljesítmény: 120W	Igen	Igen, Maximális kimenő teljesítmény: 120W
Frekvencia tartomány: 356 kHz $\pm$ 20%	Igen, kérjük megadni!	Igen, Frekvencia tartomány: 356 kHz $\pm$ 20%
Érintőképernyős grafikus kezelési felület	Igen	Igen, Érintőképernyős grafikus kezelési felület
Eszközfelismerés funkció, Plug&Play	Igen	Igen, Eszkőfelismerés funkció, Plug&Play
Kézi és pedálos aktiválási lehetőség	Igen	Igen, Kézi és pedálos aktiválási lehetőség
Rádiófrekvenciás technológiát tartalmaz	Igen	Igen, Rádiófrekvenciás technológiát tartalmaz
Frekvenciasáv: 13,56 MHz	Igen, kérjük megadni!	Igen, Frekvenciasáv: 13,56 MHz
Impedanciakontrollált bipolaris koaguláció	Igen	Igen, Impedanciakontrollált bipolaris koaguláció
Monopoláris vágás min. 4 féle : FineCut, PureCut, StrongCut, PulseCut	Igen, kérjük megadni!	Igen, Monopoláris vágás. 4 féle : FineCut, PureCut, StrongCut, PulseCut
Monopoláris coagulálás min. 2 féle: SoftCoag, ForcedCoag	Igen, kérjük megadni!	Igen, Monopoláris coagulálás 2 féle: SoftCoag, ForcedCoag
Bipoláris vágás min. 2 féle : FineCut, PureCut	Igen, kérjük megadni!	Igen, Bipoláris vágás 3 féle : FineCut, PureCut StrongCut

Monopoláris koagulálás min.: SoftCoag	Igen, kérjük megadni!	Igen, Monopoláris koagulálás SoftCoag, ForcedCoag
Rádiófrekvenciás kontrollált koaguláció	Igen	Igen, Rádiófrekvenciás kontrollált koaguláció
Ellenállás vezérelt automatikus rádiófrekvenciás mód	Igen	Igen, Ellenállás vezérelt automatikus rádiófrekvenciás mód
Kontrollált mélyszöveti koaguláció, rádiófrekvenciás abláció	Igen	Igen, Kontrollált mélyszöveti koaguláció, rádiófrekvenciás abláció
Induló alapkészlet vágóhoz : 50 db osztott EH negatív lap kábellel összeépítve	Kérjük megadni! (előny a több) 50db vagy több = 10 pont, 49 db vagy kevesebb = 0 pont	E7507, Igen, Induló alapkészlet vágóhoz : 50 db osztott EH negatív lap kábellel összeépítve
Bipoláris csipesz hajlított, kábellel 1 db	Igen	WB990033, Igen, Bipoláris csipesz hajlított, kábellel 1 db
Rádiófrekvenciás eszközök:		
Hypertrophicus mandulához 5 db	Igen	WB990008, Igen, Hypertrophicus mandulához 5 db
Lágyszájpadhoz 5 db	Igen	WB990008, Igen, Lágyszájpadhoz 5 db
Elektróda 5 db	Igen	WB990177, Igen, Elektróda 5 db
Kézinyél elektródához 1 db	Igen	WB990278, Igen, Kézinyél elektródához 1 db
Megragadó horgas csipesz 1 db	Igen	WB990202, Igen, Megragadó horgas csipesz 1 db
Lámpedál 1 db	Igen	WB50402W, Igen, Lámpedál 1 db
Kameravezérlő egység	Igen	OTV-SC2 (cikkszám: N5401160), Igen kameravezérlő egység
Kamerafej, egybeépítve vagy különálló adapterrel, mely képosztóval rendelkezik /endoszkópos és operátor általi direkt obszervációs kép is lehetséges egyidőben/	Kérjük megadni, előny a meglét! (Igen/nem) (Igen = 10 pont; Nem = 0 pont)	Igen, CH-SC2-1D (cikkszám: N5400860), Kamerafej, AR-TF08E (cikkszám: A4923,) különálló adapterrel, mely képosztóval rendelkezik /endoszkópos és operátor általi direkt obszervációs kép is lehetséges egyidőben/

Budapest, 2019. október 9.

ANAMED KFT.
1146 Budapesti, Kőszeg u. 23.
Tel: (+36) 220-9236 Fax: (+36) 221-8531
E-mail: info@anamed.hu
0-5


Virág Krisztina
cégvezető

OLYMPUS

Your Vision, Our Future

2.sz. melléklet
ESG-200
CELONELITE

Rádiófrekvenciás mikro-sebészeti generátor

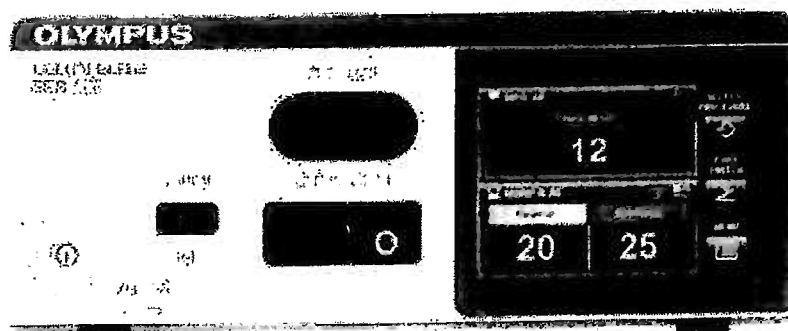

A CELON rendszer a fül-orr-gégész szakorvosokat szolgáló eljárás-orientált, biztonságos és hatékony megoldás. A CELON rendszer bipoláris, rádiófrekvencia-indukált termoterápiát alkalmaz, amely minimál-invazív és impedancia-vezérelt szövetablációt tesz lehetővé.

- Impedancia-vezérelt
- Szövetmonitorozás a biztonságos és hatékony eljárások érdekében
- Intelligens műszerkialakítás az ergonomikus kezelés érdekében
- Üzem mód kiválasztás az eljárás-orientált kezelés érdekében
- Intelligens felhasználói interfész az eljárás beállítások személyre szabásáért, valamint az időmegtakarítás érdekében
- Hatékony és gazdaságos ambuláns kezelés
- A szokványos monopoláris és bipoláris üzemmódok teljes köre az írodában és műtőben végzett eljárásokhoz

CELON



12


Elektrosebészeti generátor, CELON ELITE ESG-200

WA90001A

E típus.

WA90002A

B típus

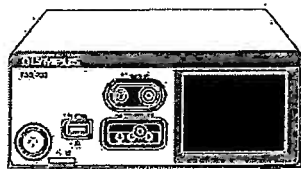

Rádiófrekvencia-alapú, teljesítmény vezérlő egység a rádiófrekvenciás eszközzel végzett kisebbítő (RFITT) és a sztetend elektrosebészeti eljárásokhoz. A Celon bipoláris applikátorokat és a Celon Elite ProCut rendszert vezérli. A folyamatos szövetmonitorozás, precíz és biztonságos szövetablációt tesz lehetővé a fül-orr-gégészeti indikációk széles körében. A beállítások személyre szabhatók a fül-orr-gégész szakorvosok és az egészségügyi személyzet mindennapos rutinfeladatainak egyszerűsítése érdekében.

A kiszállítás tartalma:

Elektrosebészeti generátor, tápkapcsoló

Műszaki adatok

Áramellátás

Feszültség.....100-120 V~ / 220 – 240 V

~ Maximális bemeneti áram.....650 VA

Méreték

Szélesség.....295 mm

Magasság.....115 mm

Mélység.....400 mm

Súly.....6,61 kg

Besorolás

Áramütés elleni védelem.....CF típus, I. osztály.

93/42/EGK irányelv.....IIb. osztály

Kimenet

Nagyfrekvenciás funkciók.....monopoláris/bipoláris

Nagyfrekvencia.....356 kHz $\pm 20\%$

Maximális nagyfrekvenciás teljesítmény.....120 W

Összes üzemmód.....25%-os kitöltési tényező
(pl. 10 s aktívált, 30 s deaktivált)

Környezeti feltételek

Üzemi hőmérséklet.....10 – 40 °C

relatív páratartalom 30 – 85 %

légnomás 700 – 106 hPa


Szállítási és tárolási.....hőmérséklet -25 – 60 °C

relatív páratartalom 10 – 85 %

légnomás 50 – 106 hPa

WB990007 Bipoláris applikátor, CelonProBreatH

GELON ELITE ESG-200-zal való használatra, steril, egyszerhasználatos, 5 db

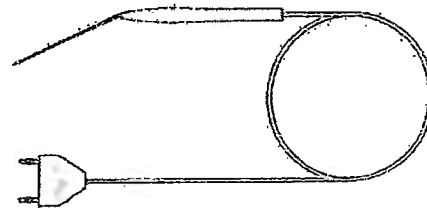

Alkalmazás:

Javasolt lágyszövet ablációhoz és koagulációhoz a fül-orr-gégészeti sebészeti területén, beleértve az orrüregi légútelzáródás kezelésére szolgáló, a hipertrófiás orrcsont csökkentésével végzett nyálkahártya alatti szövetzsugorítást.


Műszaki adatok

Applikátor csúcs.....	kúpos
Elektroda átmérő.....	1,1 mm
Elektroda hossz.....	100 mm
Markolat hossz.....	140 mm
Kábel hossz.....	3 m
Teljesítmény tartomány.....	0 – 25 W

CelonProSleep plus applikátor

WB990008 Bipoláris applikátor, CelonProSleep plus

a CELON ELITE ESG-200-zal való használatra, steril, egyszerhasználatos, 5 db

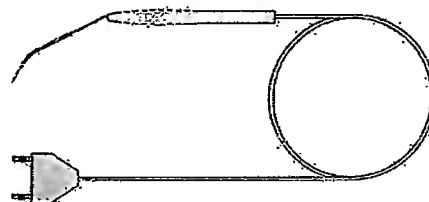

Alkalmazás:

Lágyszövet ablációhoz és koagulációhoz a fül-orr-gégészeti sebészeti területén, beleértve a nyálkahártya alatti szövetzsugorítást és szövetkoagulációt a lágyszájpadlásban a horkolás kezelésére, a szájpadlásmandulában a mandula hipertrófia kezelésére, valamint a nyelvgyökben az obstruktív alvási apnoe szindróma (OSAS) kezelésére.

Műszaki adatok


Applikátor csúcs.....	háromszög
Elektroda átmérő.....	1,3 mm
Elektroda hossz.....	140 mm
Kábel hossz.....	3 m
Teljesítmény tartomány.....	0 – 25 W

CELON ELITE ProCut rendszer

A CELON ProCut funkció monopoláris vágást tesz lehetővé a bipoláris technológia előnyeivel.

- Kíméletes és precíz vágás
- Állandó szikraintenzitású vágás a különféle szövetekben
- Rövid kezelési idő, mivel nincs szükség visszatérő elektródára
- A rádiófrekvenciás áram a kezelt szövetterületre korlátozódik
- Használható ambuláns és műtő környezetben

WB990278 Kézi darab, CELON ELITE ProCut

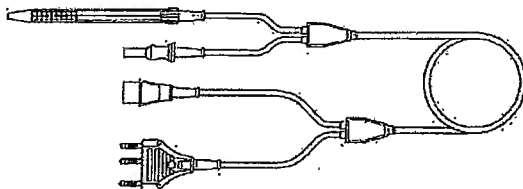

WB990177 CelonProCut-elektroda, 1. típus
(5 db)



• steril, egyszerhasználatos

WB990202 CelonProCut-megragadó fogó,
szögletes

- monopoláris



CelonForceps fogó

Bipoláris koagulációs fogó a CELON ELITE
ESG-200-zal való használatra

WB990033 CelonForceps, szögletes
(19cm, 2mm-es csúcs)



WB990034 CelonForceps, bajonett
(20cm, 1mm-es csúcs)



Rendszerábra


WB990177



WB990202



WB990278

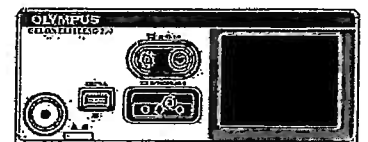

CELON ELITE ESG-200

Egyéb műszaki jellemzők:

Maximális kimenő teljesítmény: 120W
Frekvencia tartomány: 356 kHz $\pm$ 20%
Érintőképernyős grafikus kezelési felület
Eszközfelismerés funkció, Plug&Play
Kézi és pedálos aktiválási lehetőség
Rádiófrekvenciás technológiát tartalmaz
Frekvenciasáv: 13,56 MHz
Impedanciakontrollált bipoláris koaguláció
Monopoláris vágási típusok : FineCut, PureCut, StrongCut, PulseCut
Monopoláris coagulálás típusok : SoftCoag, ForcedCoag
Bipoláris vágás típusok : FineCut, PureCut StrongCut
Monopoláris koagulálás típusok SoftCoag, ForcedCoag
Rádiófrekvenciás kontrollált koaguláció
Ellenállás vezérelt automatikus rádiófrekvenciás mód
Kontrollált mélyszöveti koaguláció, rádiófrekvenciás abláció

N5401160 kameravezérlő egység.







N5400860 kamerafej




A4923 képosztó adapter

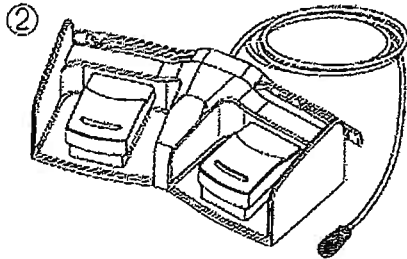

WB50402W lábpedál

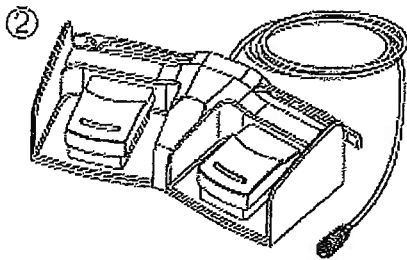

EH negatív lap kábelrel összeépítve

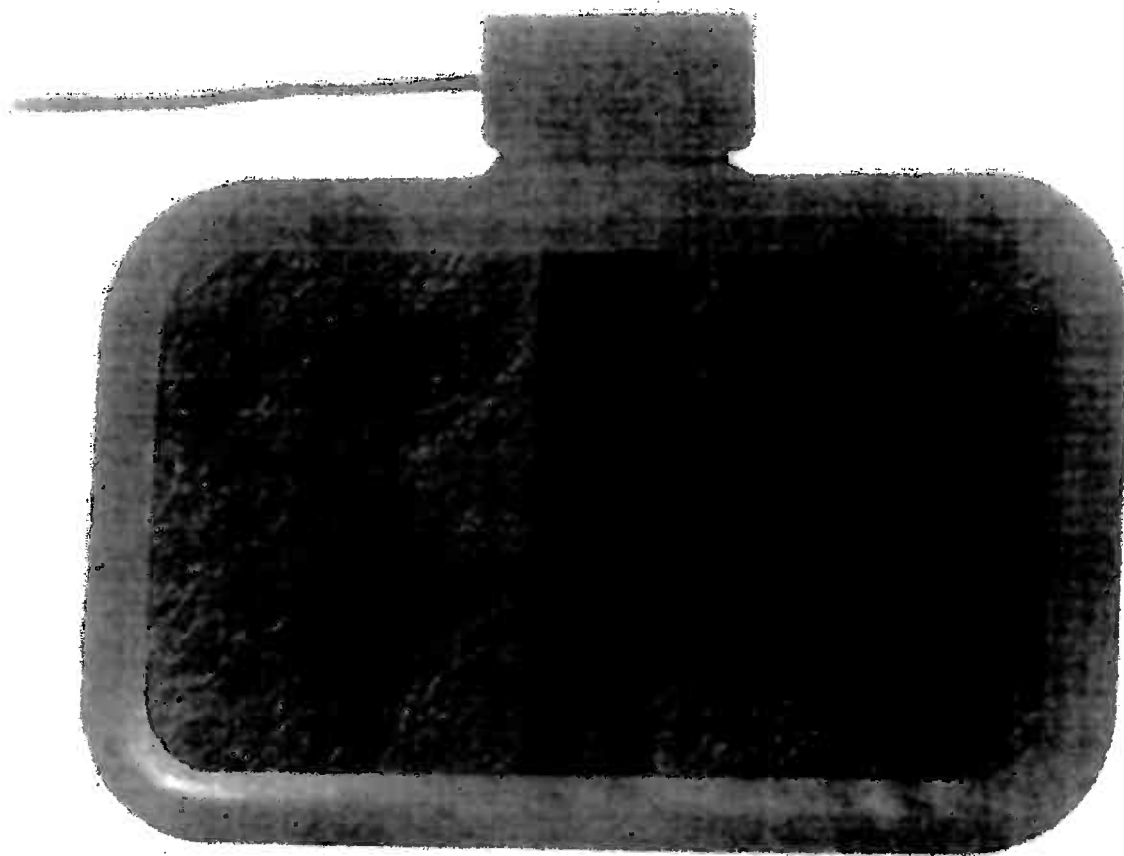

E7507, egyszerhasználatos negatív lap kábelrel összeépítve 50db, megajánlás szerint